



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie<sup>A</sup>

22-300 Krasnystaw      ul. Sobieskiego 4  
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23      fax (82) 576-49-01  
[www.spzozkrasnystaw.pl](http://www.spzozkrasnystaw.pl)      sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak sprawy OR-ZP/230-33/2016

Krasnystaw, dnia 8 grudnia 2016 r.

## Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń, serwet, podkładów i odzieży chirurgicznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę obłożeń, serwet, podkładów i odzieży chirurgicznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1

#### Pakiet nr 1 - Zestaw uniwersalny

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej oferty, prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następującym składzie i wymiarach serwet:

- serweta przylepna 150 x 240 cm
  - serweta przylepna 175 x 175 cm
  - serweta przylepna 75 x 90 cm – 2 szt.
  - ręczniki 30 x 40 cm – 4 szt.
  - taśma lepna 9 x 49 cm
  - serweta na stolik 140 x 190 cm
  - osłona Mayo 79 x 145 w kolorze niebieskim, składana teleskopowo
- opakowanie folia – papier z 3 etykietami, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala.**

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### Pytanie 2

#### Pakiet 8, pozycja 5

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej umieszczając w pozycji 4 i 5 ten sam opis przedmiotu zamówienia?

#### Odpowiedź:

Tak. Zamawiający omyłkowo umieścił dwukrotnie ten sam opis, w związku z czym dokonuje modyfikacji poz. 5 i umieszcza prawidłowy opis przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 150x210 cm, pozostałe składowe bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 4**

#### **Pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m<sup>2</sup> ze wzmocnieniami w części przedniej fartucha oraz na rękawach o gramaturze 38g/m<sup>2</sup> (15g/m<sup>2</sup> PE + 23g/m<sup>2</sup> SPPS), dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL, w opakowaniu typu folia-papier?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w/w fartucha.

### **Pytanie 5**

#### **Pakiet 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 6**

#### **Pakiet 10, pozycja 3**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie 7**

#### **Pakiet 10, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 8**

#### **Pakiet 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny typu Spunlance oraz włókniny polipropylenowej, o wymiarze 26 cm – w stanie rozciągniętym oraz 31 cm – po rozciągnięciu?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 9**

#### **Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do operacji urologicznych – TUR o składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
  - 4 ręczniki do rąk
  - 1 serweta główna 200 x 240 z otworem, zintegrowanymi osłonami na kończyny, zbiornikiem wyposażonym w sito oraz zawór do odprowadzania płynów, osłona na palec do badania per rectum
  - 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
- Włóknina trzywarstwowa, laminowana, nieprzemakalna, chłonna na całej powierzchni. Gramatura 75 g/m<sup>2</sup>.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier zawierające 3 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, producent oraz kod kreskowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 10**

#### **Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o składzie:

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm
- 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta główna 160x300 z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów Włóknina trzywarstwowa, nieprzemakalna, chłonna na całej powierzchni.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier zawierające 3 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, producent oraz kod kreskowy.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w/w zestawu.

### **Pytanie 11**

#### **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga sterylnej, czy niesterylnej osłony?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga osłony sterylnej.

### **Pytanie 12**

#### **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety dwuwarstwowej o wysokiej gramaturze min. 60g.m<sup>2</sup>, wysoko barierowej, spełniającej oczekiwania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 13**

#### **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety dwuwarstwowej o wymiarze 50x60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 14**

#### **Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety dwuwarstwowej o wymiarze 75x75cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 15**

#### **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach M, L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 16**

#### **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów w rozmiarach M, L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 17**

#### **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów o wytrzymałości na rozerwanie na sucho i na mokro min. 150kPa.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

### **Pytanie 18**

#### **Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków chirurgicznych damski, ściągniętych lekką nie uciskającą gumką. Wykonanych z fizeliny o gramaturze min. 18g/m<sup>2</sup>. Wymiary: 23+/-2cm – materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół. 55+/-2cm – materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół). Pakowany w kartonik w formie podajnika maksymalnie po 100 szt.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 19**

**Pytanie nr 1 - Dotyczy wszystkich zestawów w niniejszym postępowaniu przetargowym w których są wyroby jałowe.**

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane gazowo?

Sterylizacja radiacyjna ingeruje w strukturę materiałów co skraca ich żywotność.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie prosimy o jej uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 20**

#### **Pakiet 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o składzie:

<b>Element składowy</b>	<b>Szt.</b>	<b>Surowiec</b>	<b>Rozmiar dłxsz.(cm)</b>
serweta z przylepcem	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>	240x150
serweta z przylepcem	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56 g/m <sup>2</sup>	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150

serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włóknina kompresowa	40x20

Obłożenie na stolik Mayo w kolorze niebieskim, wykonane z folii PE o grubości 50µm, obszar wzmocnienia 85cm x 76cm +/- 2cm (co z nadmiarem pokrywa całość standardowego stolika o wymiarach 61 cm x 40cm), gramatura wzmocnienia 74g/m<sup>2</sup>. Taśma medyczna wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>. Serwetki do rąk wykonane z włókniny kompresowej (67% wiskozy, 33% poliestru) o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> oraz chłonności 900%. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu – najbardziej popularną metodą sterylizacji wyrobów medycznych stosowaną przez większość firm oferujących obłożenia jednorazowego użytku. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w składzie.

### **Pytanie 21**

#### **Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu zgodnego z wymogami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ, gdzie jedyną różnicą będą: serwetki do rąk wykonane z włókniny kompresowej (67% wiskozy, 33% poliestru) o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> oraz chłonności 900%; taśma medyczna o wymiarach 9cm x 50cm wykonana z włókniny spunlace o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>; obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 145cm x 80cm, posiadające obszar wzmocnienia 85cm x 79cm, gramatura wzmocnienia 85g/m<sup>2</sup>? Pozostałe składniki zestawu zgodne z SIWZ. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu – najbardziej popularną metodą sterylizacji wyrobów medycznych stosowaną przez większość firm oferujących obłożenia jednorazowego użytku. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w składzie.

### **Pytanie 22**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie 23**

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy (§7 i §3).

### **Pytanie 24**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

### **Pytanie 25**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ilość wyrobów które zamówi zależy od liczby faktycznie hospitalizowanych pacjentów i ich problemów zdrowotnych.

### **Pytanie 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 6 ust 2. lit. a) wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie 27**

#### **Przedmiot zamówienia – Pakiet nr 1**

**Poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego, w którym serwety wykonane są z dwuwarstwowego laminatu PP + PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm – wykonana z folii o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem z włókniny o wymiarach 60 x 145 cm, o łącznej gramaturze wzmocnienia 90 g/m<sup>2</sup>, kolor aqua

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm – wykonana z włókniny poliestrowej

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm – wykonane z celulozy o gramaturze ok 55g/m<sup>2</sup>

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu, zawierający dwie samoprzylepne etykiety.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw o w/w składzie.

### **Pytanie 28**

#### **Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 1 zaoferowania niżej opisanego zestawu?

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150x240 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm wykonana z włókniny PE 40g/m<sup>2</sup>
- 1 x wzmocniona serweta na stół instrumentalny 150x190cm, stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Wyrób zgodny był z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier typu Tyvec zawierające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejscu lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

## Pytanie 29

### Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 3 zaoferowania niżej opisanego zestawu?

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230x260 cm z wycięciem „U” o wymiarach 20x100 cm, wykonana z włókniny trójwarstwowej (PE+PP+PP) w strefie pacjenta o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej 140g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150x240 cm wykonana w strefie pacjenta z włókniny 3 warstwowej (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkową łatą chłonną 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm wykonana z włókniny PE 40g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 x 120 cm
- 1 x serweta 180x180cm wykonana w strefie pacjenta z włókniny 3 warstwowej (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkową łatą chłonną 80 g/m<sup>2</sup>
- 2 x serweta 75x90cm wykonana z włókniny 3 warstwowej (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkową łatą chłonną 80 g/m<sup>2</sup>
- 1 x bandaż elastyczny 12cm x 6m

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier typu Tyvec zawierające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejscu lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

## Pytanie 30

### Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający oczekuje w pakiecie nr 4 zaoferowania niżej opisanego zestawu?

- 1 x serweta o wymiarach 230x300 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 7 cm, wykonana z włókniny trójwarstwowej w strefie przeznaczonej dla Pacjenta 75 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm wykonana z włókniny PE 40g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22x75 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej 140g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej 140g/m<sup>2</sup>

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier typu Tyvec, zawierające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejscu lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

### Pytanie 31

#### Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie nr 6 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta ginekologiczna o wymiarach 270/230 x 260 cm, zintegrowana z nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem samoprzylepnym 24 x 21cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej PE+PP o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier typu Tyvec, zawierające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejscu lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

### Pytanie 32

#### Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie w pakiecie nr 7 zestawu w składzie zgodnym z opisanym w SIWZ, zgodnego z normą PN-EN 13795, sterylizowanego tlenkiem etylenu, w opakowaniu papier-folia typu Tyvec zawierającym 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejscu lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa).

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w/w zestawu.

### Pytanie 33

#### Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 niej opisanego zestawu?

- 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm, wykonana z włókniny o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), gramatura części podstawowej 55g/m<sup>2</sup>, łączna gramatura części wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana z kierunku rozwijania.
- 2 ręczniki do rąk 30,5x34cm wykonane z celulozy 55g/m<sup>2</sup>
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>
- 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>

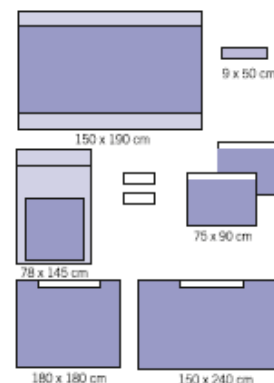



- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Serweta w części podstawowej wykonana z PE o gramaturze 55g/m<sup>2</sup> oraz części wzmocnionej o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier zawierające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie 34

#### Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 niej opisanego zestawu?

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230x260 cm z wycięciem „U” o wymiarach 20x100 cm, wykonana z włókniny trójwarstwowej (PE+PP+PP) w strefie pacjenta o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej 140g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150x240 cm wykonana w strefie pacjenta z włókniny 3 warstwowej (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkową łatą chłonną 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm wykonana z włókniny 40g/m<sup>2</sup>
- 1 x elastyczna osłona na kończybę o wymiarach 30 x 120 cm
- 1 x serweta 180x180cm wykonana w strefie pacjenta z włókniny 3 warstwowej (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkową łatą chłonną 80 g/m<sup>2</sup>
- 2 x serweta 75x90cm wykonana z włókniny 3 warstwowej (PE+PP+PP) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup> z dodatkową łatą chłonną 80 g/m<sup>2</sup>
- 1 x bandaż elastyczny 12cm x 6m

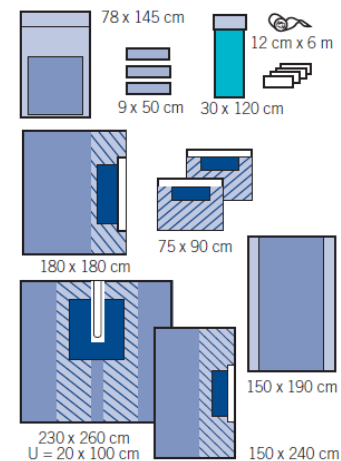

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier zawierające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejscu lokalizacji na polu operacyjnym.

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

### Pytanie 35

#### Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 niżej opisanego zestawu?

- 1 x serweta o wymiarach 230x300 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 7 cm, wykonana włókniny trójwarstwowej w strefie przeznaczony dla Pacjenta 75 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z organizatorami przewodów

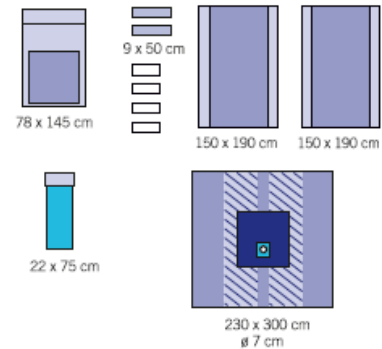

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>

- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm wykonana z włókniny 40g/m<sup>2</sup>

- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22x75 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 78x145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 65x85cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej 140g/m<sup>2</sup>

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz warstwy chłonnej o gramaturze 85g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej 140g/m<sup>2</sup>

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier, zawierające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejscu lokalizacji na polu operacyjnym.

**Odpowiedź:**


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

**Pytanie 36**

**Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta ginekologiczna o wymiarach 270/230 x 260 cm, zintegrowana z nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem samoprzylepnym 24 x 21cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej PE+PP o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5x34 cm wykonany z celulozy o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

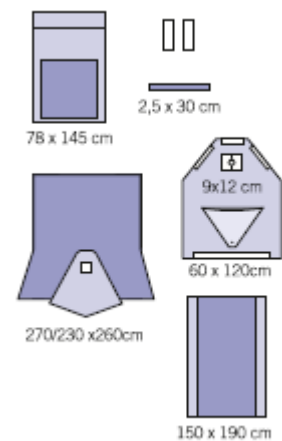

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier, zawierające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejscu lokalizacji na polu operacyjnym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

### **Pytanie 37**

#### **Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie w pakiecie nr 7 zestawu w składzie zgodnym z opisanym w SIWZ, zgodnego z normą PN-EN 13795, sterylizowanego tlenkiem etylenu, w opakowaniu papier-folia, zawierającym 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Każda serweta posiada informację o kierunku rozkładania, a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 38**

#### **Dotyczy pakietu 1 – zestaw uniwersalny**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnych wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> o następujących parametrach:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150x240 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175 x 200 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy o wymiarach 30x 40 cm wzmocniony syntetyczną siatką o gramaturze 68 gsm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup>
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 x 145 cm wykonana z folii PE o grubości 0,065mm oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach min. 60 x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 140x190cm.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier zawierające informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, nazwa dostawcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

### **Pytanie 39**

#### **Dotyczy pakietu nr 7 – zestaw serwet do cięcia cesarskiego**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do cięcia cesarskiego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> o następujących parametrach:

- 1 x serweta do cięcia cesarskiego w kształcie T o wymiarach 200/250x315cm z przylepnym oknem o wymiarach 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min. wymiarach 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem
- 1 x serweta dla dziecka o wymiarach 90 x 100 cm
- 1 x serweta na stół do instrumentarium o wymiarach 140 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 80 x 145 cm
- 2 x ręcznik do rąk
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier zawierające informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, nazwa dostawcy oraz kod kreskowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o w/w składzie.

#### **Pytanie 40**

##### **Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 2 lit. a projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W takim przypadku zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis §10 na następujący:

„Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w §5 ust. 2 lit. a) oraz ust. 4”.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie  
(*podpis nieczytelny*)  
mgr Piotr Matej